
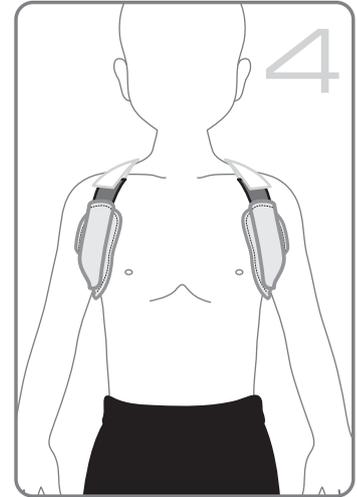
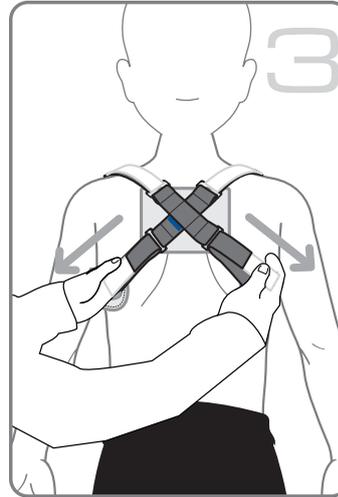
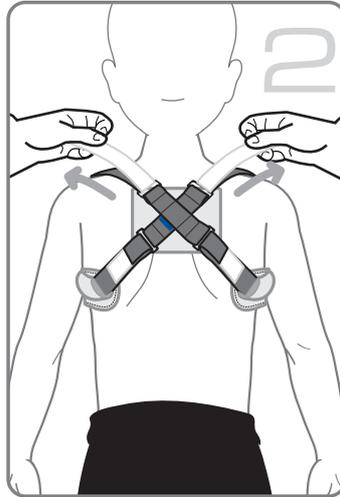


Kids

INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

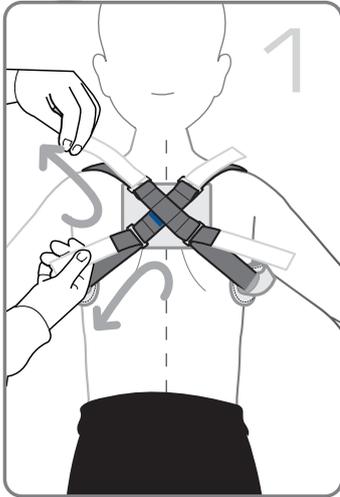

Posicione la placa del Inmovilizador de Clavícula centrado en la espalda del paciente, situando las cinchas superiores por encima de los hombros y las inferiores, en ambos costados. Seguidamente regule las cinchas de tracción equilibradamente ejerciendo la tracción necesaria hasta obtener la retroimpulsión deseada.